無痛分娩看護マニュアル　2025.4.10

コール基準

観察項目	観察時間	コール基準　対応	留意事項
体温	1～2 時間ごと	38℃以上 ・クーリング ・補液追加	比較的多い所見 機序不明（反応性？） 感染との鑑別
脈拍	連続監視	100 回/分以上　45 回/分以下 ・徐脈時は麻酔レベルチェック ・左側臥位 ・補液 ・急変対応考慮	仰臥位低血圧 脱水・発熱・疼痛 局所麻酔中毒 広域麻酔 アナフィラキシー
血圧	30 分毎 ※初回投与後は５分ごとに血圧を測定する	90/60mmHg 以下（上下ともに） ・左側臥位 ・補液流速アップ ・昇圧剤 ・急変対応考慮	広域麻酔（くも膜下） 局所麻酔中毒 仰臥位低血圧 迷走神経反射 アナフィラキシー
SpO_2	連続監視	94%以下 ※呼吸数（異変があるとき計測） ９回/分以下もしくは 25 回/分以上	広域麻酔 局所麻酔中毒 アナフィラキシー
CTG	連続監視	レベル３以上 ・体位変換 ・酸素投与 ・アトニン中止 ・急速輸液 ・緊急弛緩（ミリスロール原液 0.4 cc　iv）	初回投与後 30 分程度に注意 過強陣痛（ブロックの反応） 子宮破裂 胎盤早期剥離 臍帯脱出
コールドテスト	疼痛時 VS の変動時	麻酔領域がないもしくは TH8 以上 麻酔領域は得ているが痛い 麻酔領域に左右差やばらつきがある ・カテーテル再挿入 ・効かせたい方向を下方へする体位 ・突発痛と考えレスキュー依頼	カテーテルの自然抜去や迷入 麻酔薬の濃度が薄い 回旋異常 胎盤早期剥離 切迫子宮破裂

無痛分娩準備物品

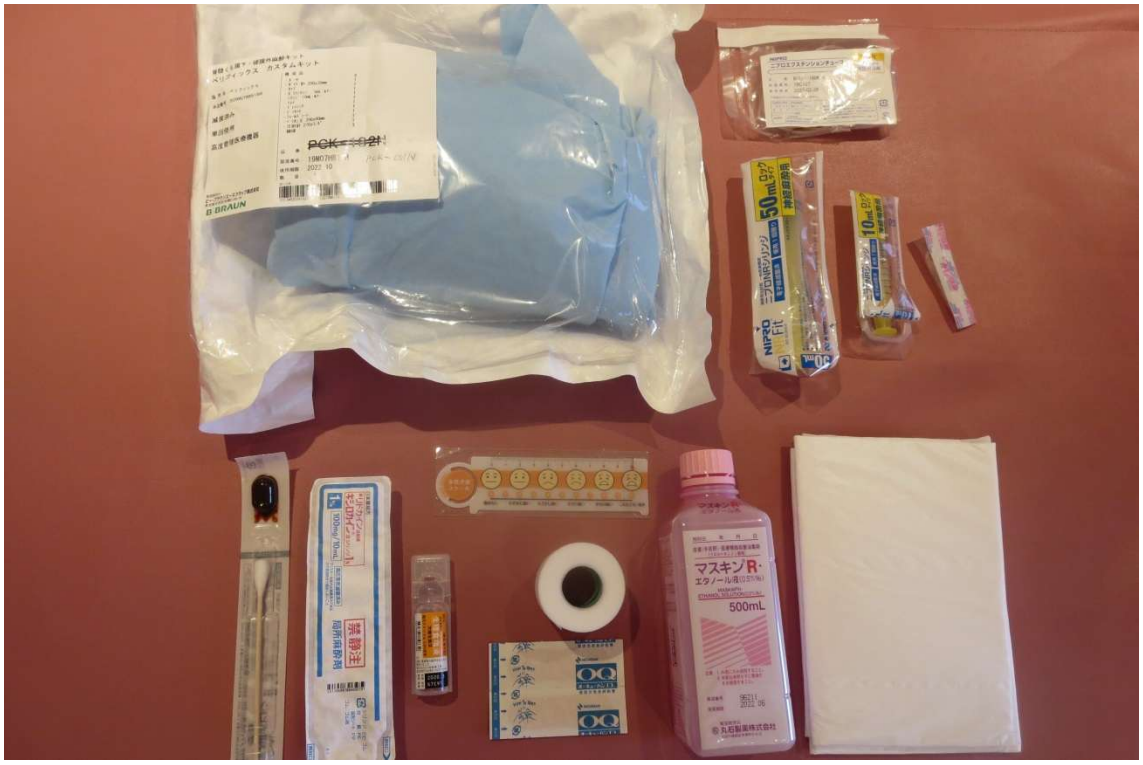

① 硬膜外麻酔キット
② 硬膜外用エクステンションチューブ
③ 硬膜外用 50 ccシリンジ　２本
④ 硬膜外用 10 ccシリンジ　１本
⑤ 硬膜外用 18Gピンク針　１本
⑥ イソジン消毒綿棒
⑦ 1%キシロカイン 10 cc
⑧ 生理食塩水 20ml
⑨ VAS スコア
⑩ ニチバンテープ　５㎝幅
⑪ カットバン
⑫ マスキンＲ消毒液
⑬ 防水シーツ